



検査キット (使用前に必ずご確認ください)

- ① 抗体試験カード 1 ② 展開液&スポイト1
 (密封袋入り) ③ 採血針 1 ④ 消毒綿 1
 ⑤ 止血パッド 1 ⑥ 血液採取ピペット 1

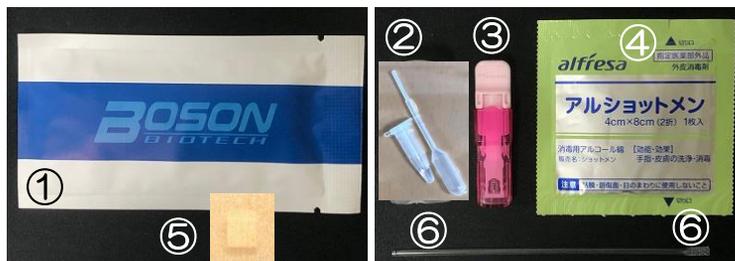

採血針の使用方法

採血針はホルダーを持って「カチッ」と音がするまで指に押し付けてください

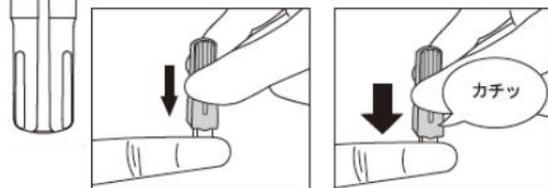

1 準備

- 操作する手をきれいに洗い、採血する指の部位を決めます。
- 机の上に透明袋から取り出したキットをならべ、①～⑥を確認します。
- BOSON抗体試験カード①を袋から取り出し、水平に置きます。
- 消毒綿④の袋を開け、消毒綿で採血する指を丁寧に拭き、乾かします。

2 血液の採取

- 採血針③の蓋をねじって保護キャップ(白色)を外します。
 ※ 内蔵された針はピンク色のホルダーの中に隠れています。本体を「カチッ」と音がするまで強く指に押し付けます。(針が一度だけ飛び出して引っ込むように設計されています。一度きりで、二度目は使用できませんのでご注意ください)
- 血液採取ピペット⑥の黒線のある側を確認します。
- 採血する指をよく揉んで血行を良くしたのち、採血部位を上向きに机の上に置きます。
- 採血針③のピンク色容器の白い先端部分を指に当て、一気に力を入れて、カチッと音がするまで押します。
- 採血部位の周りを押して、血液が直径1～2mmの球状にします。
- 血液採取ピペット⑥の中ほどを指でつまんで、血液に当て、指を緩めて血液を吸い取り、黒線の位置まで採取します。
- 採血した部位は、必要に応じて止血パッド⑤を貼って保護してください。



展開液容器②の蓋を開けてスポイトで液を吸いとり、S穴に1滴を滴下します


3 抗体試験カードによる試験

- 血液採取ピペットで採取した血液を、抗体試験カードの四角のS1穴(検体投入口)に垂直な位置で、ピペットの中ほどを押してS1穴に入れます。
- 展開液②の容器の蓋を開け、ピペットを用いて液を吸い上げます。
- 抗体試験カードの大きな丸いS穴(展開液投入口)に1滴を滴下します。
- 展開液が浸みて、検出部のほうへ液が広がっていくことを確かめ、10分間待ちます。強い陽性の場合には早く結果が示されます。(BOSON社の最新最速製品を使用)



4 判定

- (1) 試験開始から10分経過したら、キットの「C」「G」「M」のそれぞれの位置に、赤い線が表示されているか否かを確認します。
- (2) 「C」の位置に赤い線が表示された場合、本検査が良好に実施されたことを示しています。
- (3) 「G」の位置に赤い線が表示された場合は、IgG抗体が検出されたことを示しています。
- (4) 「M」の位置に赤い線が表示された場合は、IgM抗体が検出されたことを示しています。
- (5) 「C」の位置に赤い線が表示されない場合、または15分以降に表示されたラインは無効です。

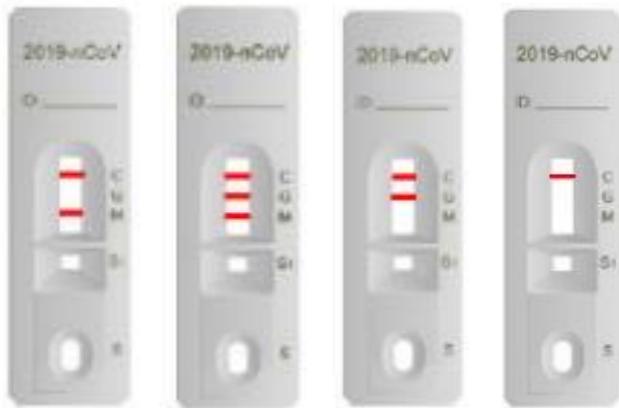

5 注意事項

- (1) 本キットは、2019年コロナウイルスに対するIgG抗体およびIgM抗体を迅速に調べることができる定性的評価キットですので、抗体の正確な濃度を測定するものではありません。
- (2) 採血針は一度きりの使用ですので、十分にご注意ください。
- (3) IgM及びIgG抗体がわずかしか生産されていない、もしくは測定量が非常に低い場合には、偽陰性(本当は陽性であるが陰性を示す)の結果が生じることがあります。
- (4) コロナウイルスの検査には、①コロナウイルスのRNAを増幅して調べるPCR法、②抗原のたんぱく質を調べる抗原検査法、そして、③抗体を調べる抗体検査法があります。それぞれの検査法の特徴をいかしてご利用ください。
- (5) 使用後の採血針や検査カードは、各都道府県の指針に従い、適正に廃棄処分してください。
- (6) 新型コロナウイルス抗体検査キットは現在、わが国では体外診断用医薬品として位置づけられていませんので、診断に用いることはできないことにご留意ください。

| | IgM 陽性 | IgM IgG 陽性 | IgG 陽性 | IgM IgG 陰性 |
|----|-------------|---------------|----------------|---------------|
| C | ○ | ○ | ○ | ○ |
| G | × | 赤線 | 赤線 | × |
| M | 赤線 | 赤線 | × | × |
| 評価 | 発症初期の可能性が高い | | 感染状態 | 既感染 |
| | 直ちに医療機関等へ | | 症状があれば医療機関等へ相談 | |

6 お困りの時には


- (1) 本キットの使用等に関しては下記までお問合せください

E-mail: corona.info@jifa.org

販売代理店

東京都新宿区新宿1-23-10 安田ビル3階

特定非営利活動法人 日本国際親善協会 (JIFA)

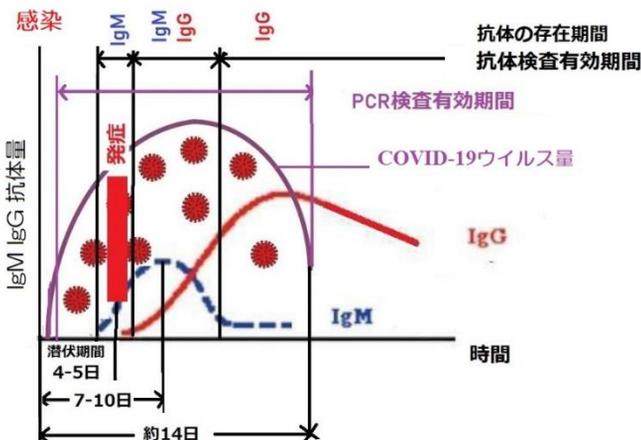

- (2) 本キットの提供については、世界各国におけるコロナウイルス感染防止に貢献できるよう、日本国際親善協会が活動の一環として取り組んでおります。本キットの普及の収益は、各国の子供たちの学資支援や環境改善支援にも利用させていただきます。ご意見やご要望がございましたらお寄せください。

日本総輸入元：アイオウェア株式会社

〒101-0034 東京都千代田区神田東紺屋町31

神田横町トライアングルタワー5F

高度管理医療機器販売業・貸与業許可第4501170036号

国内総取扱元：株式会社アイプラスプラス

〒130-0011 東京都墨田区石原 1-27-1新佐川ビル201

国内発売元：有限会社ヴァリエ

〒173-0037 東京都板橋区小茂根 2-16-8 202

販売代理店：

日本国際親善協会 (JIFA) / グローバルドリーム財団

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-23-10 安田ビル3階